

狀態:	New	開始日期:	2024-04-23
優先權:	Normal	完成日期:	
被分派者:	Chifu Chung	完成百分比:	0%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時

概述

2. 校正相關資料探討

目前狀況：

沒找到相關模型校正文獻，因此先尋找市面產品如何操作校正 – 以Samsung Galaxy Watch為例

“三星電子”血壓應用軟體，衛部醫器輸字第034608號，北市衛器廣字第111110112號 (2022. 04)




2. 校正相關資料探討



為了確保更準確的校正，請遵守以下事項：

- 1) 進行校正前30分鐘，請勿飲食任何酒精或咖啡因，也請勿吸菸、運動或洗澡。
- 2) 確保手腕和手腕之間乾燥、沒有過多的汗水或過多乳液。
- 3) 請於安靜室內進行校正。
- 4) 於桌子旁擺上舒適的椅子。
- 5) 坐在椅上，背部得到充分支撐，雙腳沒有交叉且平放於地面上。
- 6) 請將手和前臂放於桌上。
- 7) 開始校正前，請於保持5分鐘休息。
- 8) 校正開始，當使用手腕式血壓計測量請保持靜止且請勿移動手臂與說話。
- 9) 於測量期間請正常呼吸，請勿深呼吸或減緩呼吸。

2. 校正相關資料探討

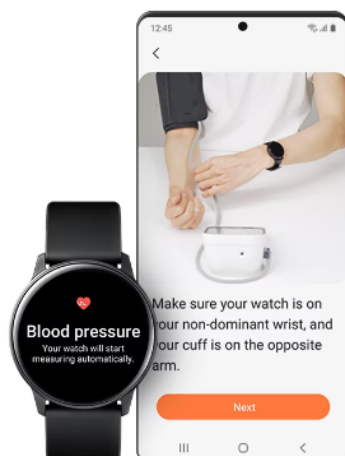

開始校正 Galaxy Watch

- 1) 將血壓帶放置於上手臂。
- 2) 將 Samsung Galaxy Watch 戴在另一隻手腕上。確保 Galaxy Watch 緊貼在手腕上，但不要太緊。
- 3) 請將 Galaxy 智慧手機放於桌上且可方便取得。
- 4) 請於您的 Galaxy 智慧手機上打開 Samsung Health Monitor 應用軟體，然後點擊本產品，依照螢幕指示來進行以下操作：
 1. 開始手腕式血壓計測量血壓
 2. Galaxy Watch 自動開始進行測量
 3. 請將手腕式血壓計測量數值輸入到手機上。
 4. 再次重複前面步驟兩次 (總共三次測量) 來完成校正 Galaxy Watch。

* 備註：當您在30分鐘內連續校正兩次時，系統會提示您，為了將 Galaxy Watch 正確地校正，當您28天內重複校正三次時，您可以跳過前兩次測量並直接重複最後兩次校正 Galaxy Watch。

Samsung量測作法較為個性化的方式。

QA：
我們的作法為訓練一個模型量所有人，但不管iphone Face ID、指紋解鎖在使用前都有一個讓使用者校正的動作，或許之後可以考慮這樣的實驗設計？

檔案

clipboard-202404231733-f7v2h.png	119 KB	2024-04-23	Chifu Chung
clipboard-202404231733-acat3.png	212 KB	2024-04-23	Chifu Chung
clipboard-202404231733-imfek.png	164 KB	2024-04-23	Chifu Chung